

NYE AKER

MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 1


J - LABORATORIEMEDISIN



NYE AKER

MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 1 J - LABORATORIEMEDISIN

Innholdsfortegnelse	
NSA - Plan U1, 01, 03	
Oversiktstegninger rom til medvirkning plan 01 og 03	
Romliste	
Romskisser og spørsmålslister pr. rom:	
Romnr	Romnavn
10.01.005	Laboratorium, patologi
10.01.035 og 059	Utlevering blod og instrumentrom
10.01.037	Vaskerom
10.01.058	Arbeidsrom, IKT
10.01.004, 056 og 060	Laboratorium mikrobiologi, mikroskopi og instrumentrom
10.01.065	Kontor, patolog
Prøvetaking	
10.02.023	Laboratorium, prøvetaking
10.01.001	Laboratorium, akuttmottak
10.02.022	Prøvetaking

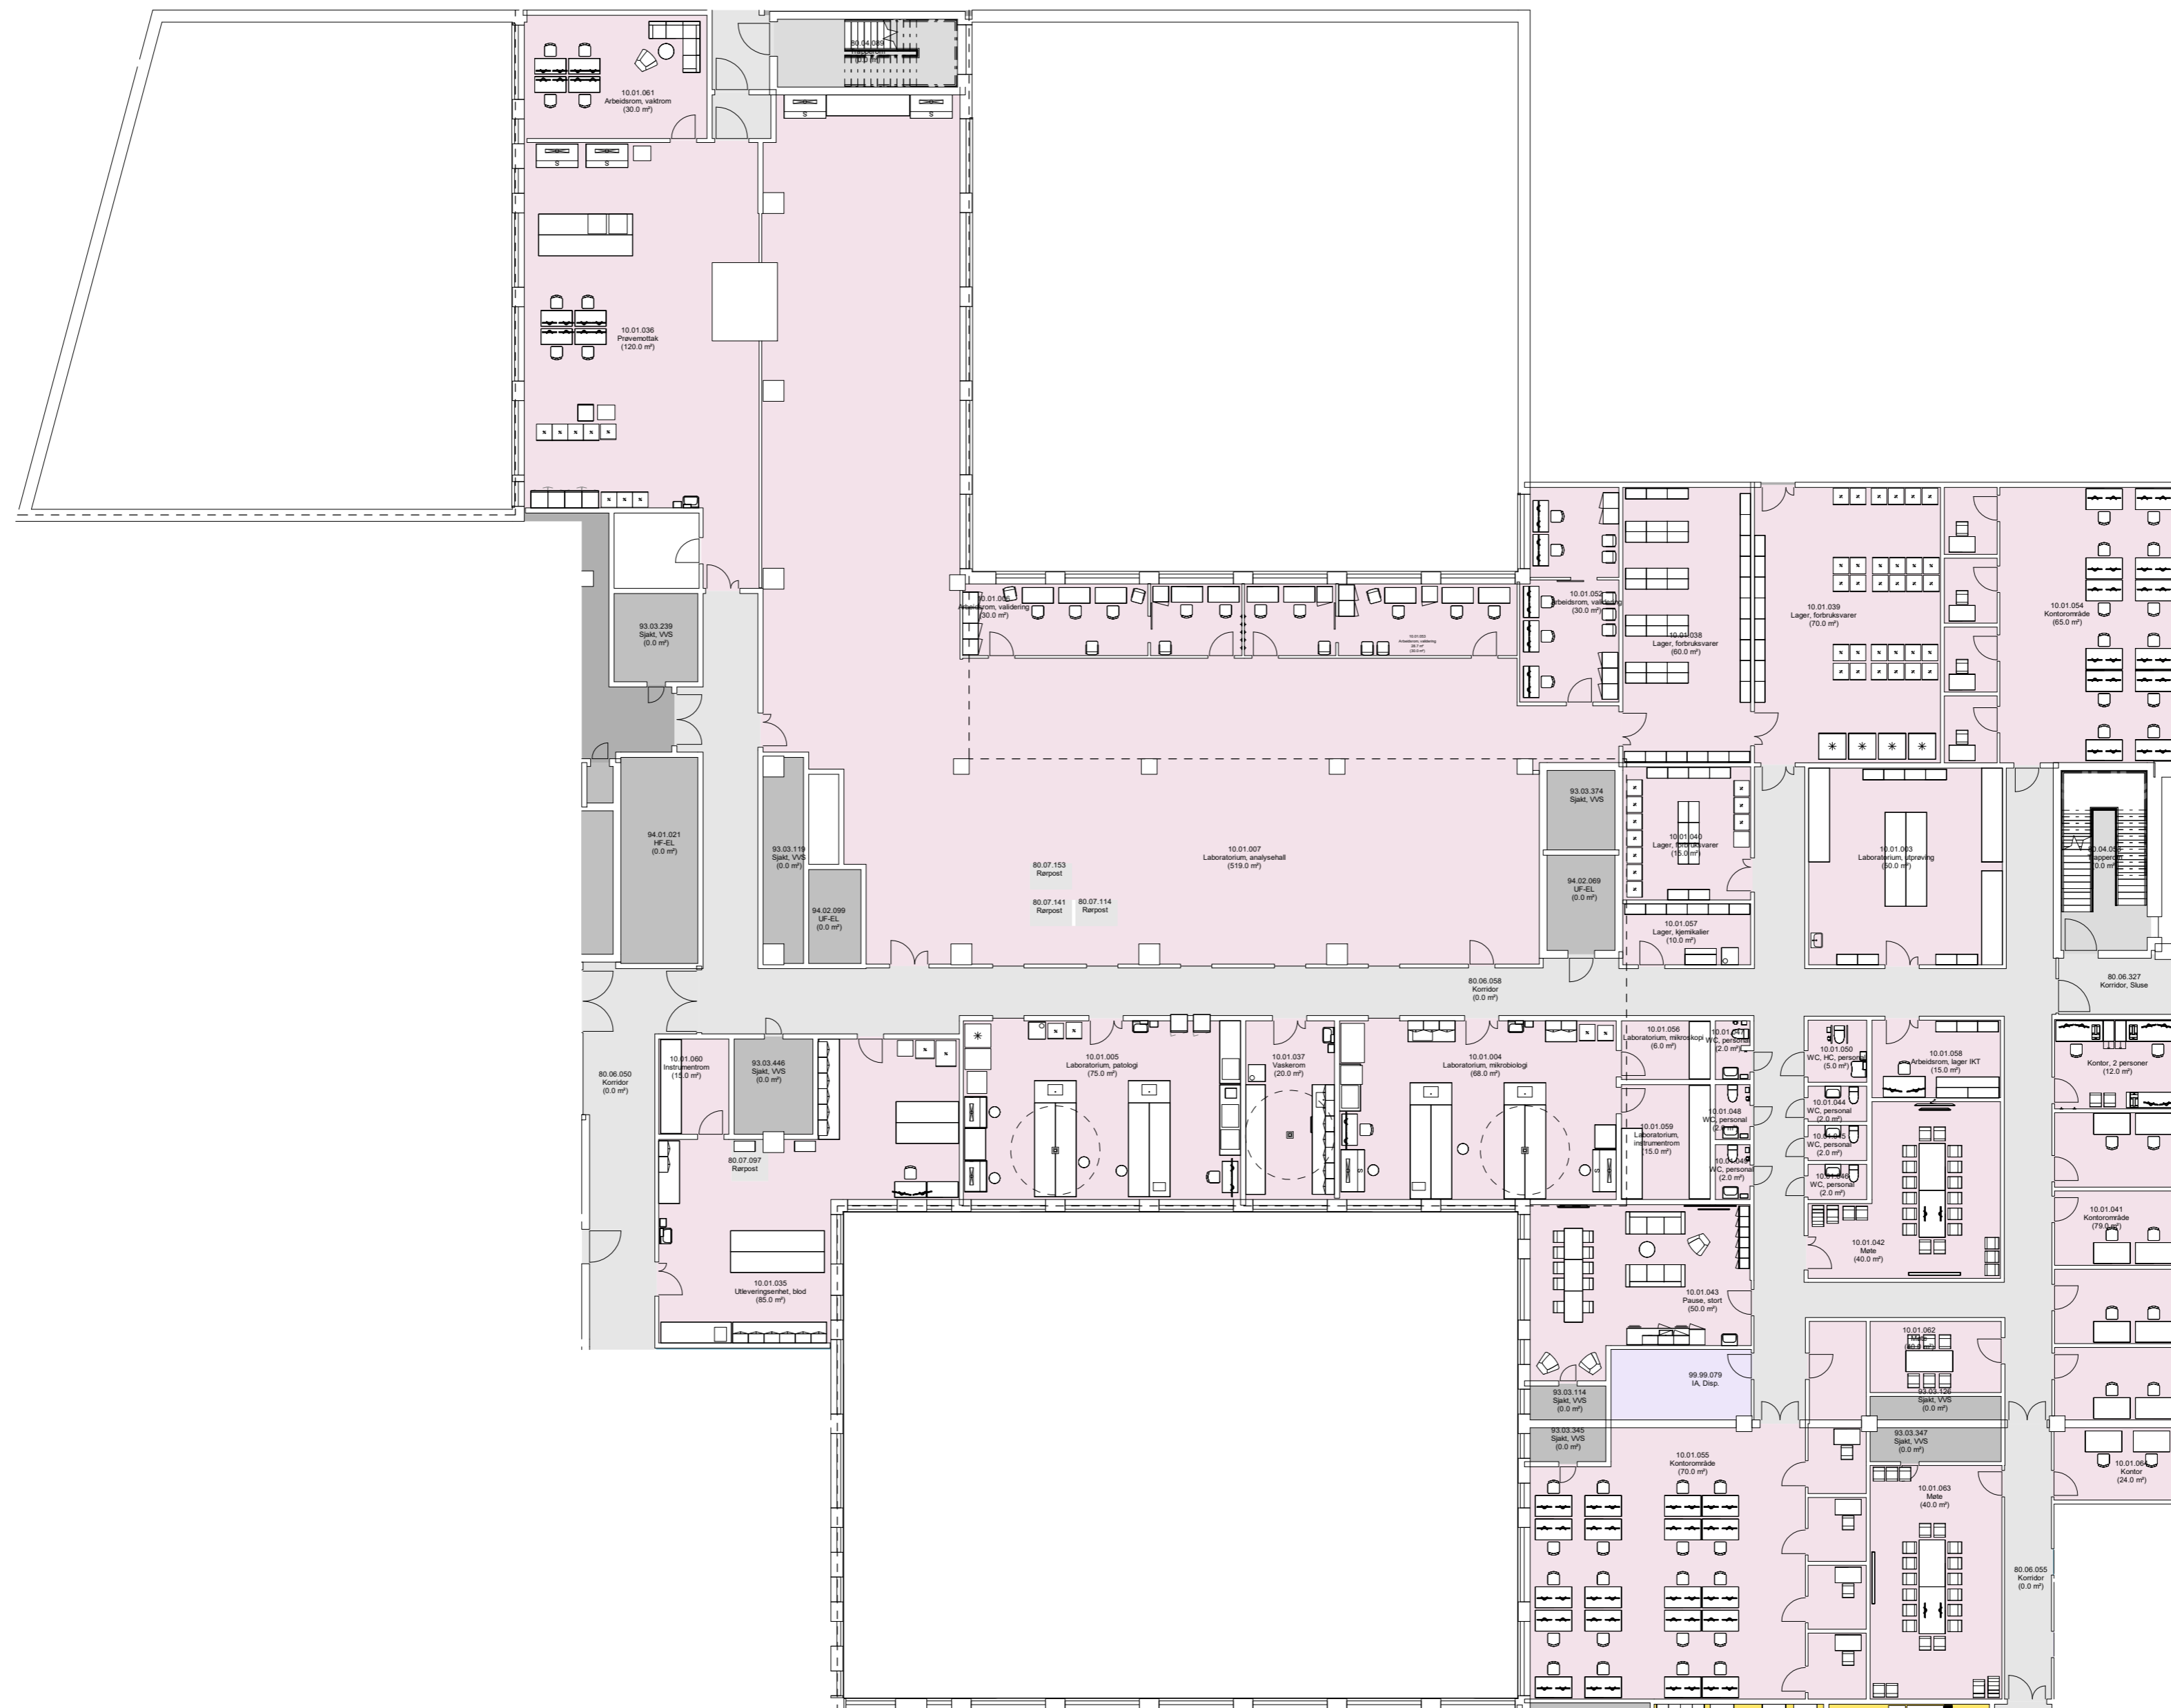

FORELØPIG TEGNING


Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 200


10.01. - Laboratoroemedisin, Analyse Plan 03

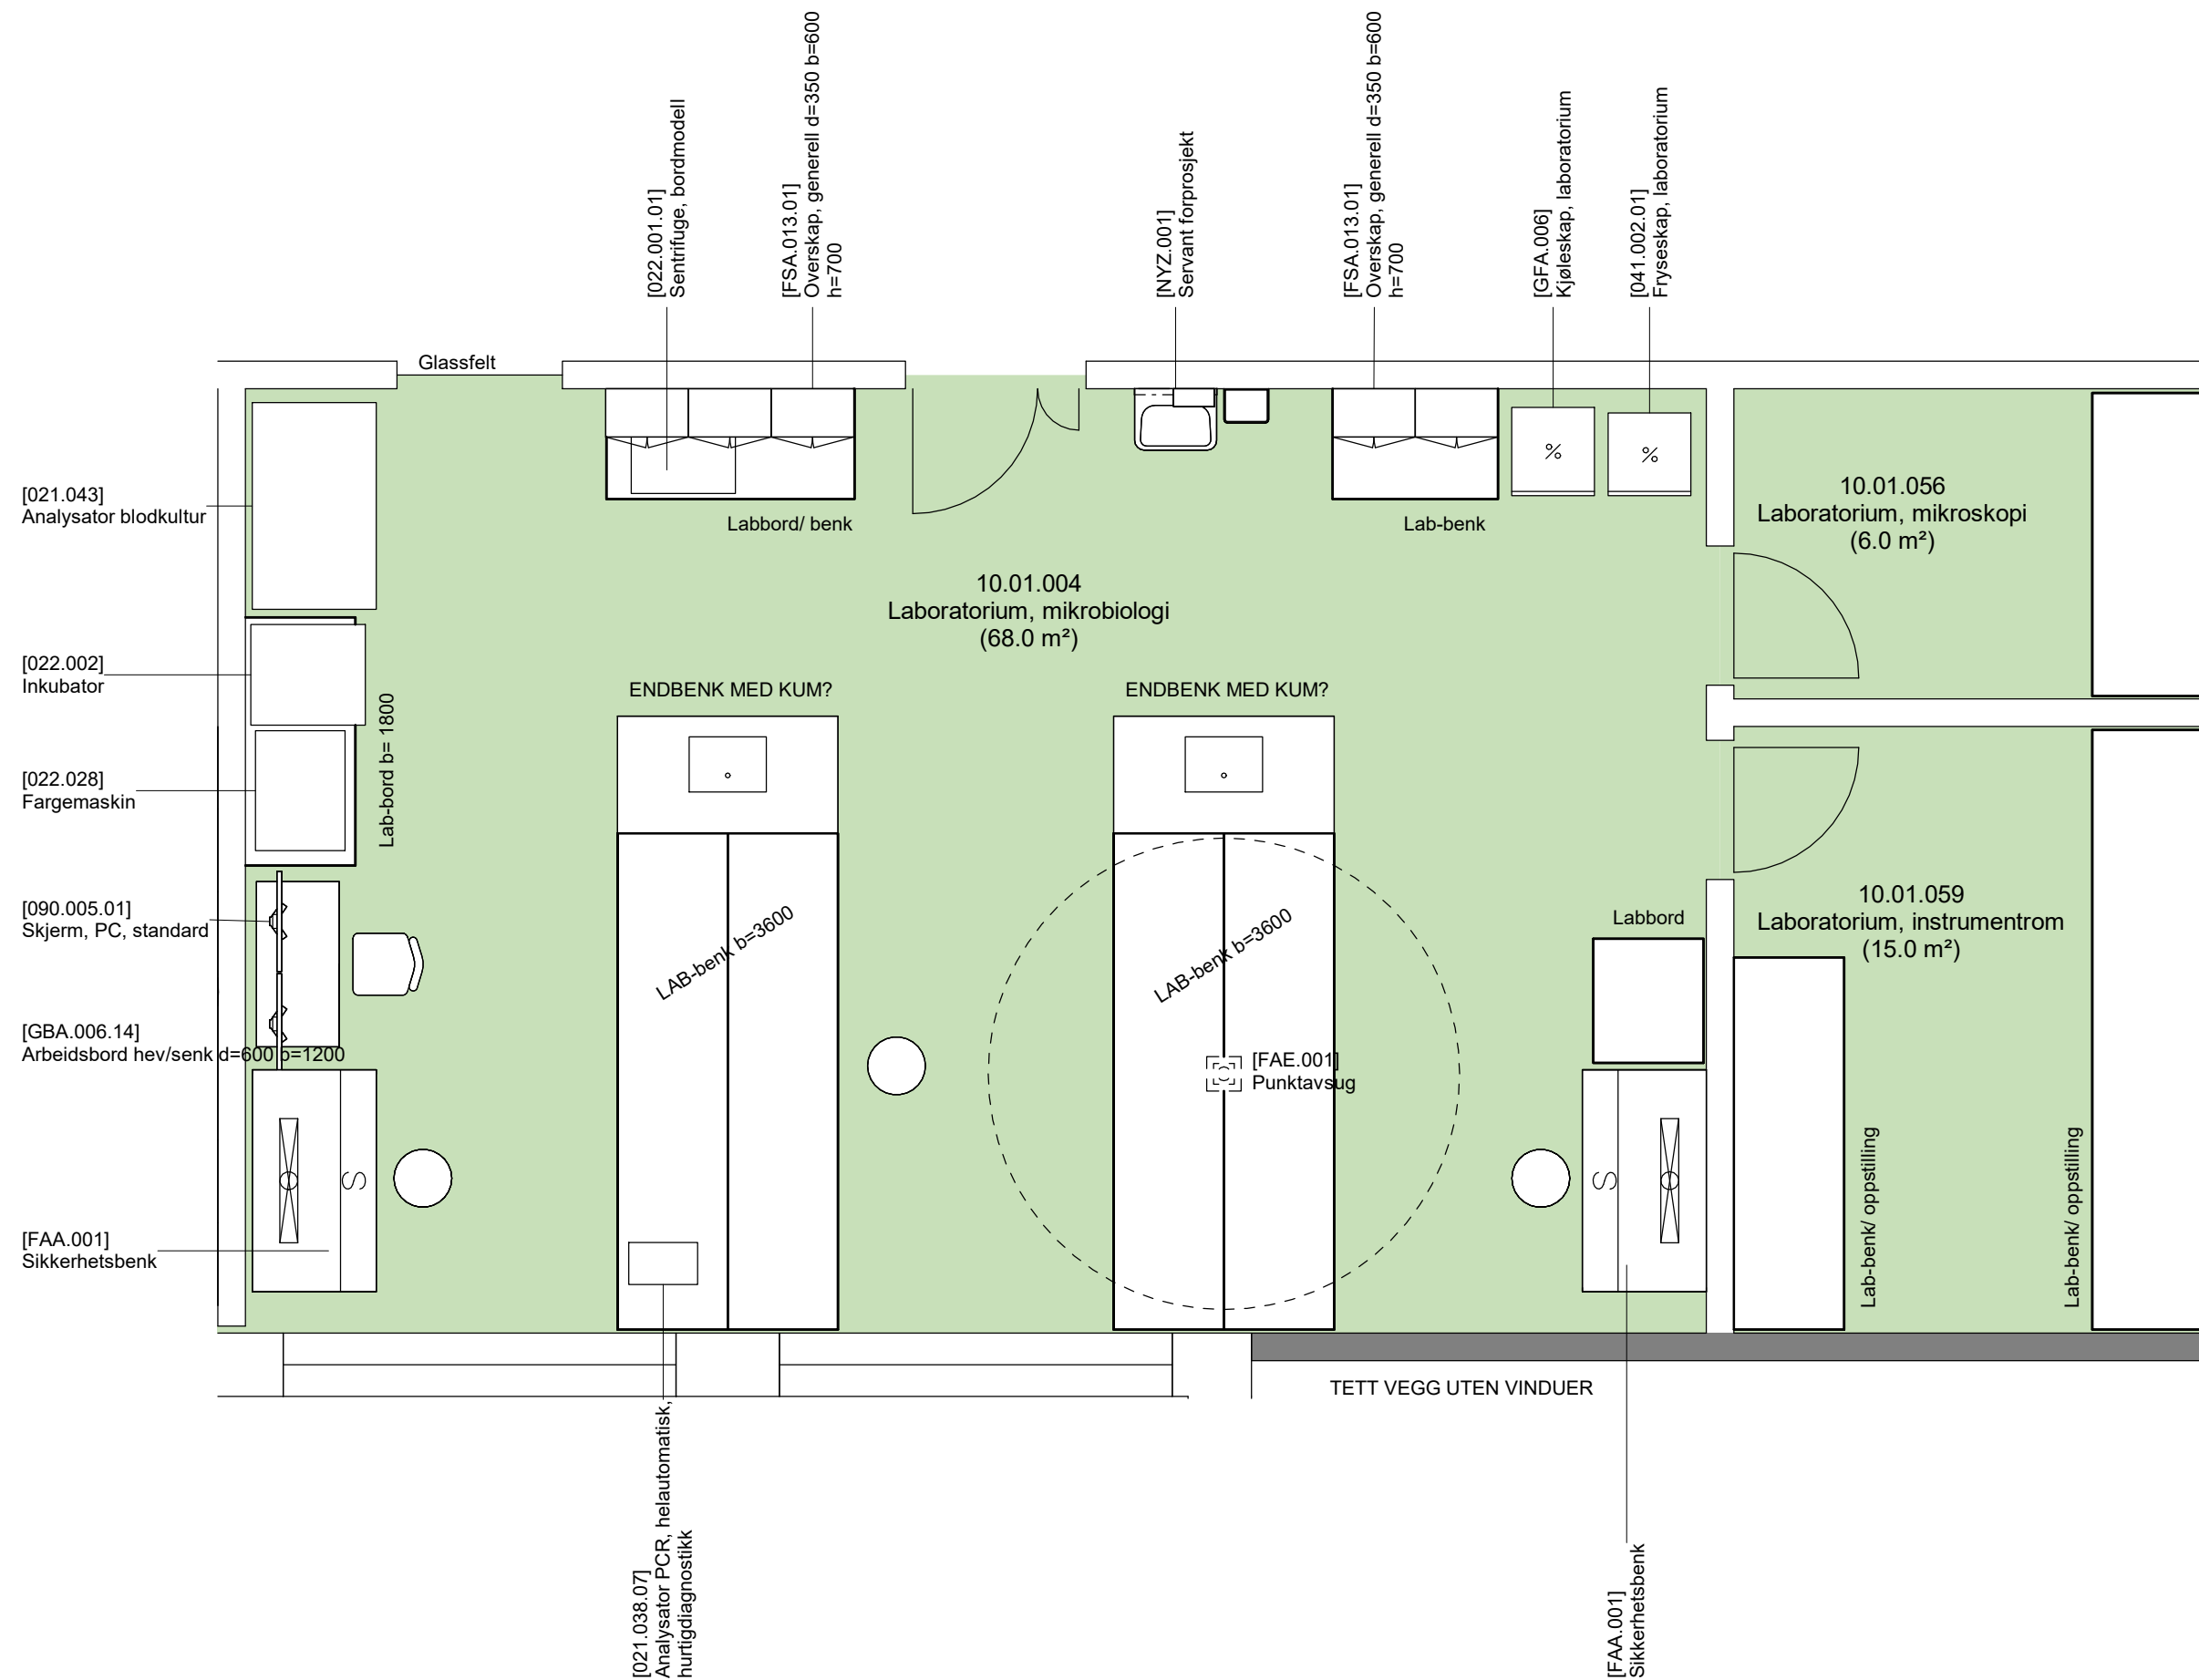

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023
Mål: 1 : 50

Nye Aker
10.01.004 (1) - Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)



FORELØPIG TEGNING

Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker

Mål: 10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)

HELSE  SØR-ØST

 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS



TEAM  AKER

Avklaringspunkter til rom

10.01.004 LABORATORIUM, MIKROBIOLOGI

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Sentrifuger		Skal det benyttes egne bordtyper for sentrifuger?		
2	Hvor mange skal jobbe her samtidig?		Inkl. UIO		
3	Sikkerhetsbenk		Bør sikkerhetsbenkene samles eller kan de plasseres på hver side av rommet, som vist i skissen? Hvilken funksjon (aktivitet) skal sikkerhetsbenkene ivareta? Størrelse på sikkerhetsbenken?		
4	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?		Er foreslått løsning hensiktsmessig med tanke på arbeidsflyt?		
5	Renset vann - type I		Er det behov for vannbehandlingsenhet lokalt i lab eller hentes det fra nærliggende rom? pt ligger ingen vannrenseenhet i		
6	Type og plassering punktavsug	FAE.001 / Punktavsug	Hva brukes punktavsug til?		

Avklaringspunkter til rom


10.01.056 LABORATORIUM, MIKROSKOPI

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Hvilket type innredning er det behov for å oppfylle funksjonen til rommet?				
2	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				

Avklaringspunkter til rom

10.01.060 INSTRUMENTROM

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Hvilken type innredning og utstyr har man behov for å ivareta funksjonen i rommet?				
2	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				
3	I automasjonsfane i RFP står det at gassdeteksjon må avklares		Hvilke gasser skal detekteres og hvor/hvordan oppstår de i rommet?		
4	I automasjonsfane i RFP er det haket av for deteksjon på temperatur		Vil det være spesielle temperaturkrav i rommet?		

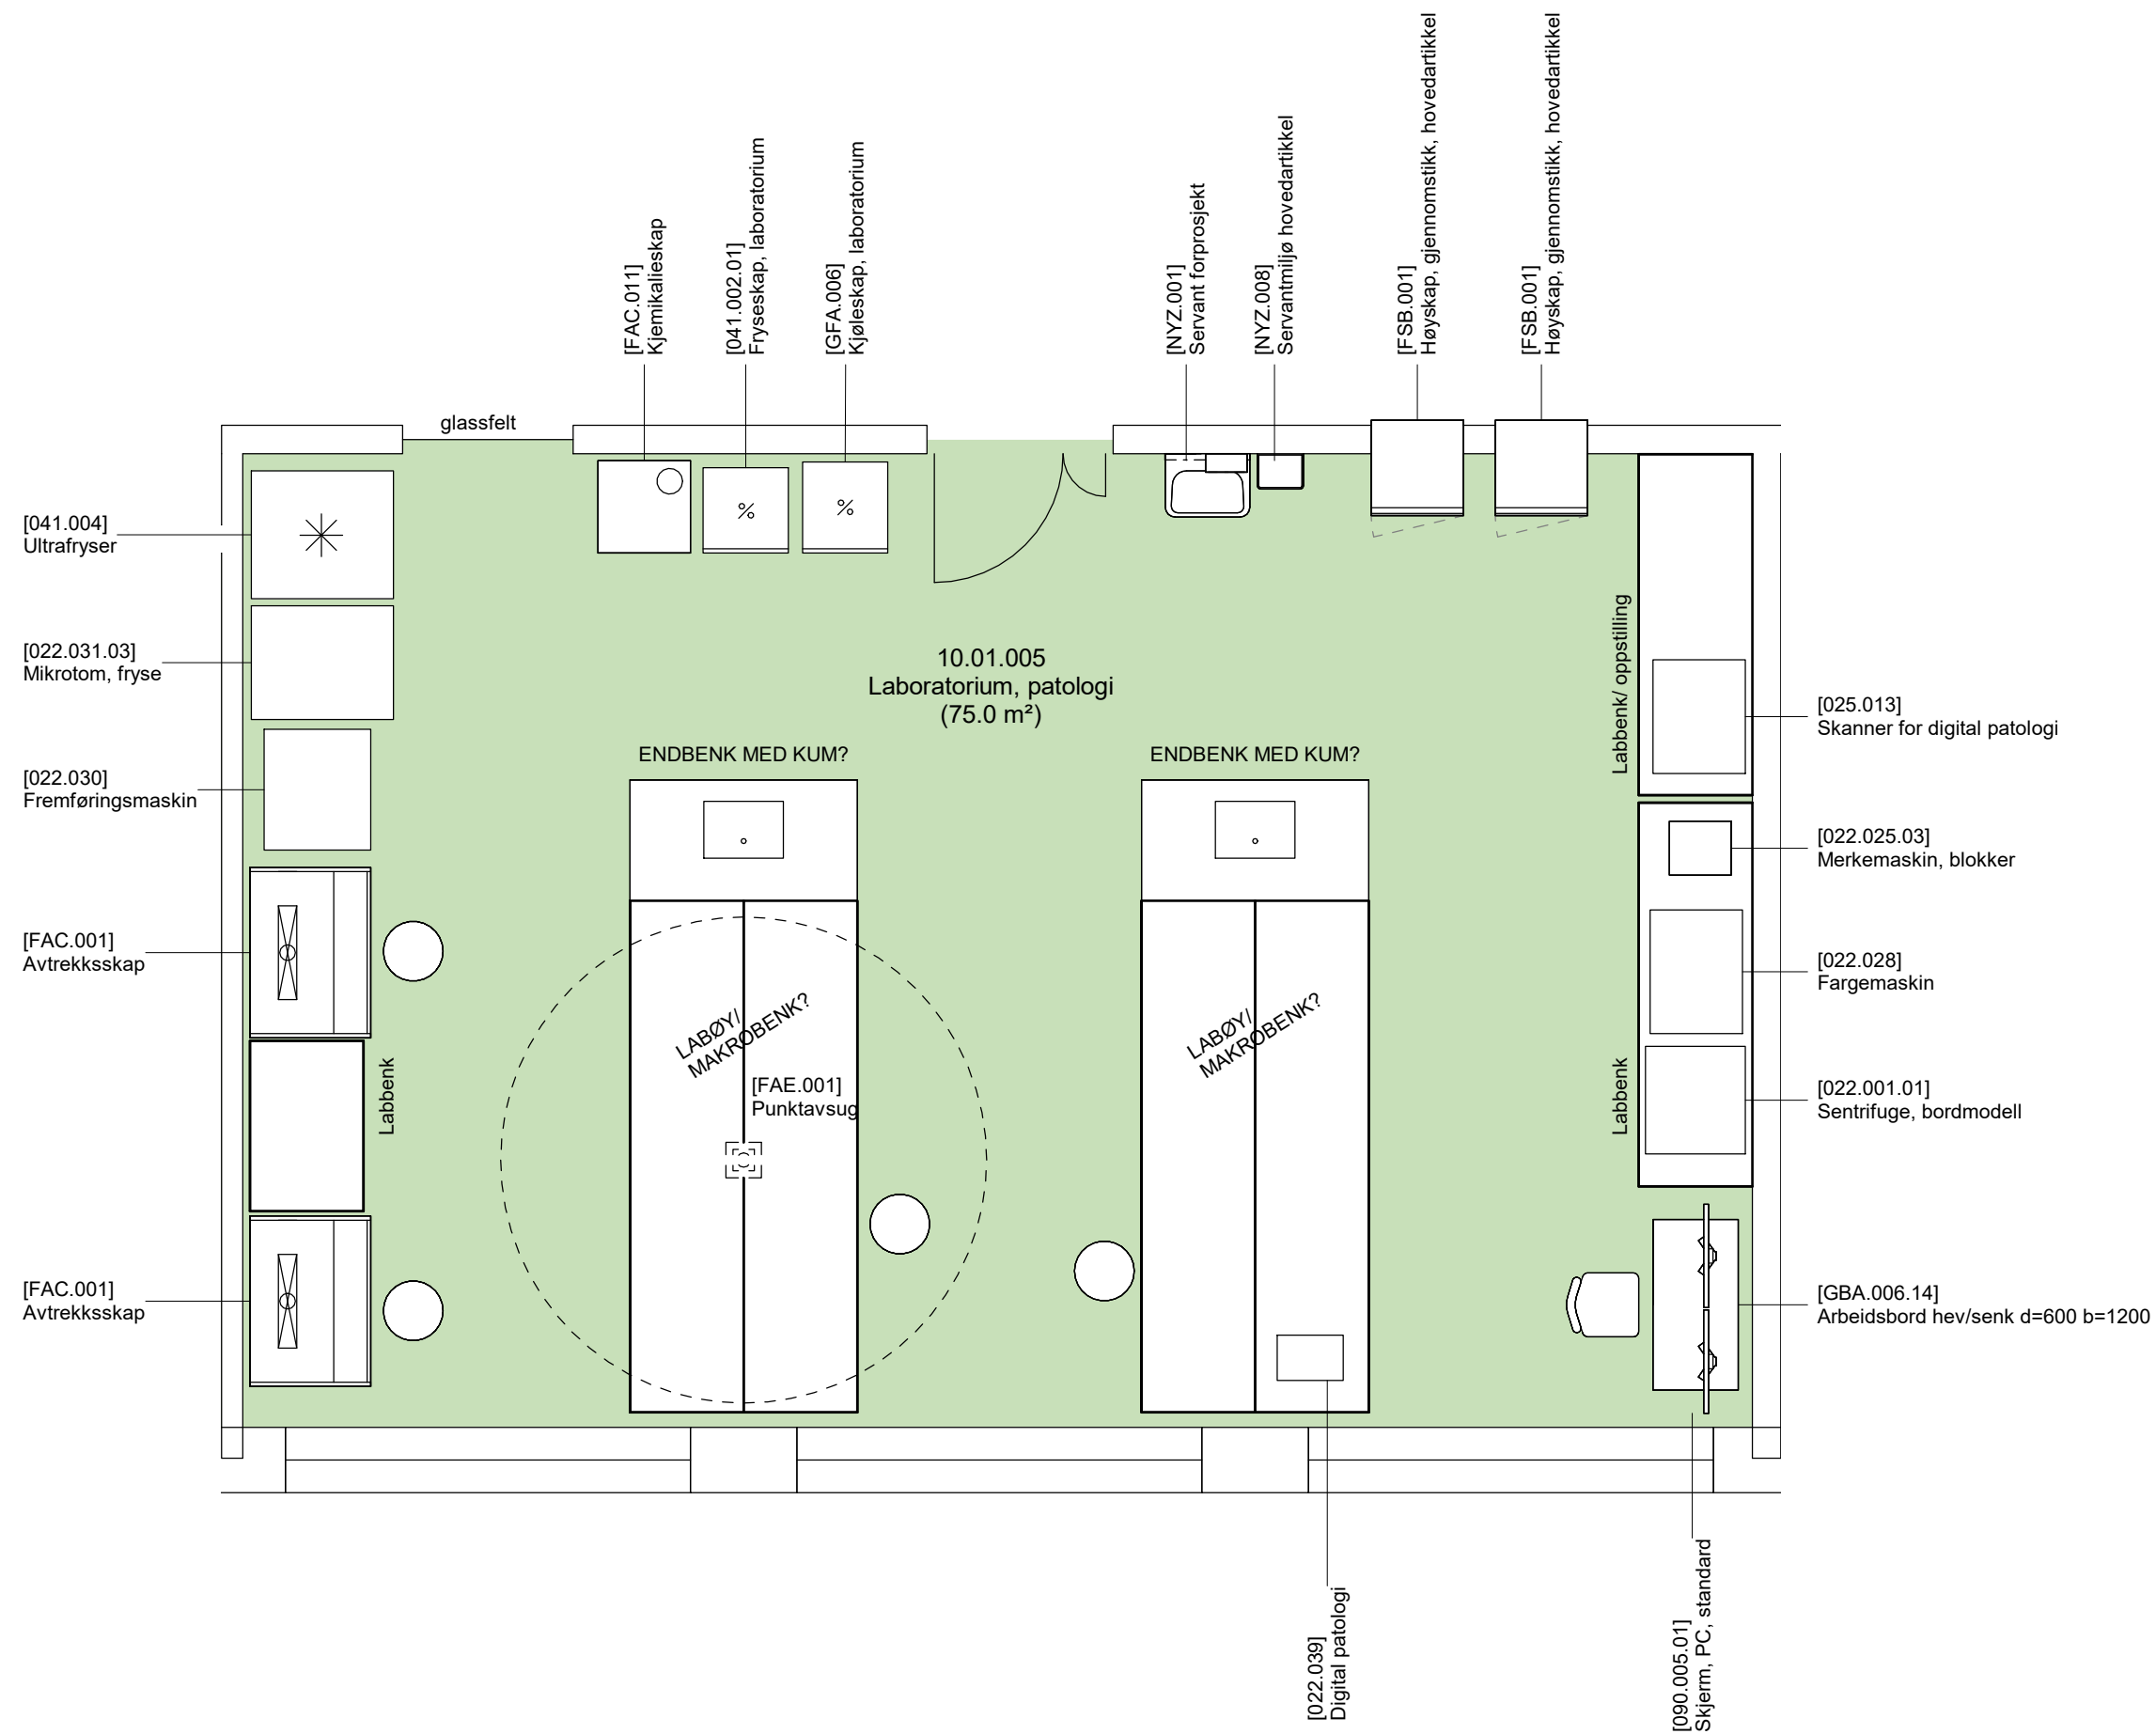


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 50

10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)



FORELØPIG TEGNING

Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker

Mål: 10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)

HELSE  SØR-ØST  OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS




TEAM  AKER

Avklaringspunkter til rom

10.01.005 LABORATORIUM, PATOLOGI

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS		
1	Gjennomstikk høyskap fra korridor	FSB.001	Ikke angitt i drøfus, men tegnet. Er antall og plasseringen ok? Størrelse? Skal prøver <i>inn</i> og prøver <i>ut</i> være mer adskilt? Skal skapet være ventilert?			
2	Avtrekkskap	FAC.001	Avtrekkskap er plassert samlet på samme side av rommet. Ok plassering eller 1 stk på hver side? Størrelse?			
3	Makrobenk	FAC.010	Plassering, størrelse, antall? Kum i benk?			
4	Punktavsug	FAE.001	Hensiktsmessig plassering? Over spesifikt utstyr eller arbeidsbenk? Hva brukes punktavsuget til?			
5	Sentrifuger		Skal det benyttes egne typer bord / benk for sentrifuger?			
6	Hvor mange personer jobber her samtidig? (MIN/ MAKS)					
7	Skal noe av utstyret plasseres i nærhet til kum eller punktavsug?					
8	Spesialavfall		Egne beholdere? plassbehov?			
9	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?		Er foreslått løsning hensiktsmessig med tanke på arbeidsflyt?			
10	Type og størrelse kjemikalieskap	FAC.011 / Kjemikalieskap	Hvilke kjemikalier og mengder oppbevares i rommet?			
11	Funksjon og plassering avtrekkshette		Hva er bruksområde og egnet plassering for avtrekkshette? Ligger pt ikke i utstyrsliste.			
12	Utstyr tilknyttet avtrekk		Skal utstyr utover utstyr for beskyttelsesventilasjon tilknyttes avtrekk?			
13	Type I vann		Benyttes type I vann kun til 022.028 Fargemaskin? Er det manuell påfylling og evt tømning av denne? Hentes type I vann fra tilliggende rom? pt ligger ingen vannrenseenhet i utstyrslisten.			
14	For tilkoblinger tappevann og avløp er det oppført "spesifiseres senere"		Pt er det kun servant som har tilknytning til tappevann og avløp - er det ytterligere behov?			
15	Makrobenk er angitt med avløp med spesielle renskrav mhp kjemikalier (formalin, alkohol, fargestoffer)		Oppstår avløp med renskrav kun i makrobenk? Hvilke mengder er det snakk om?			

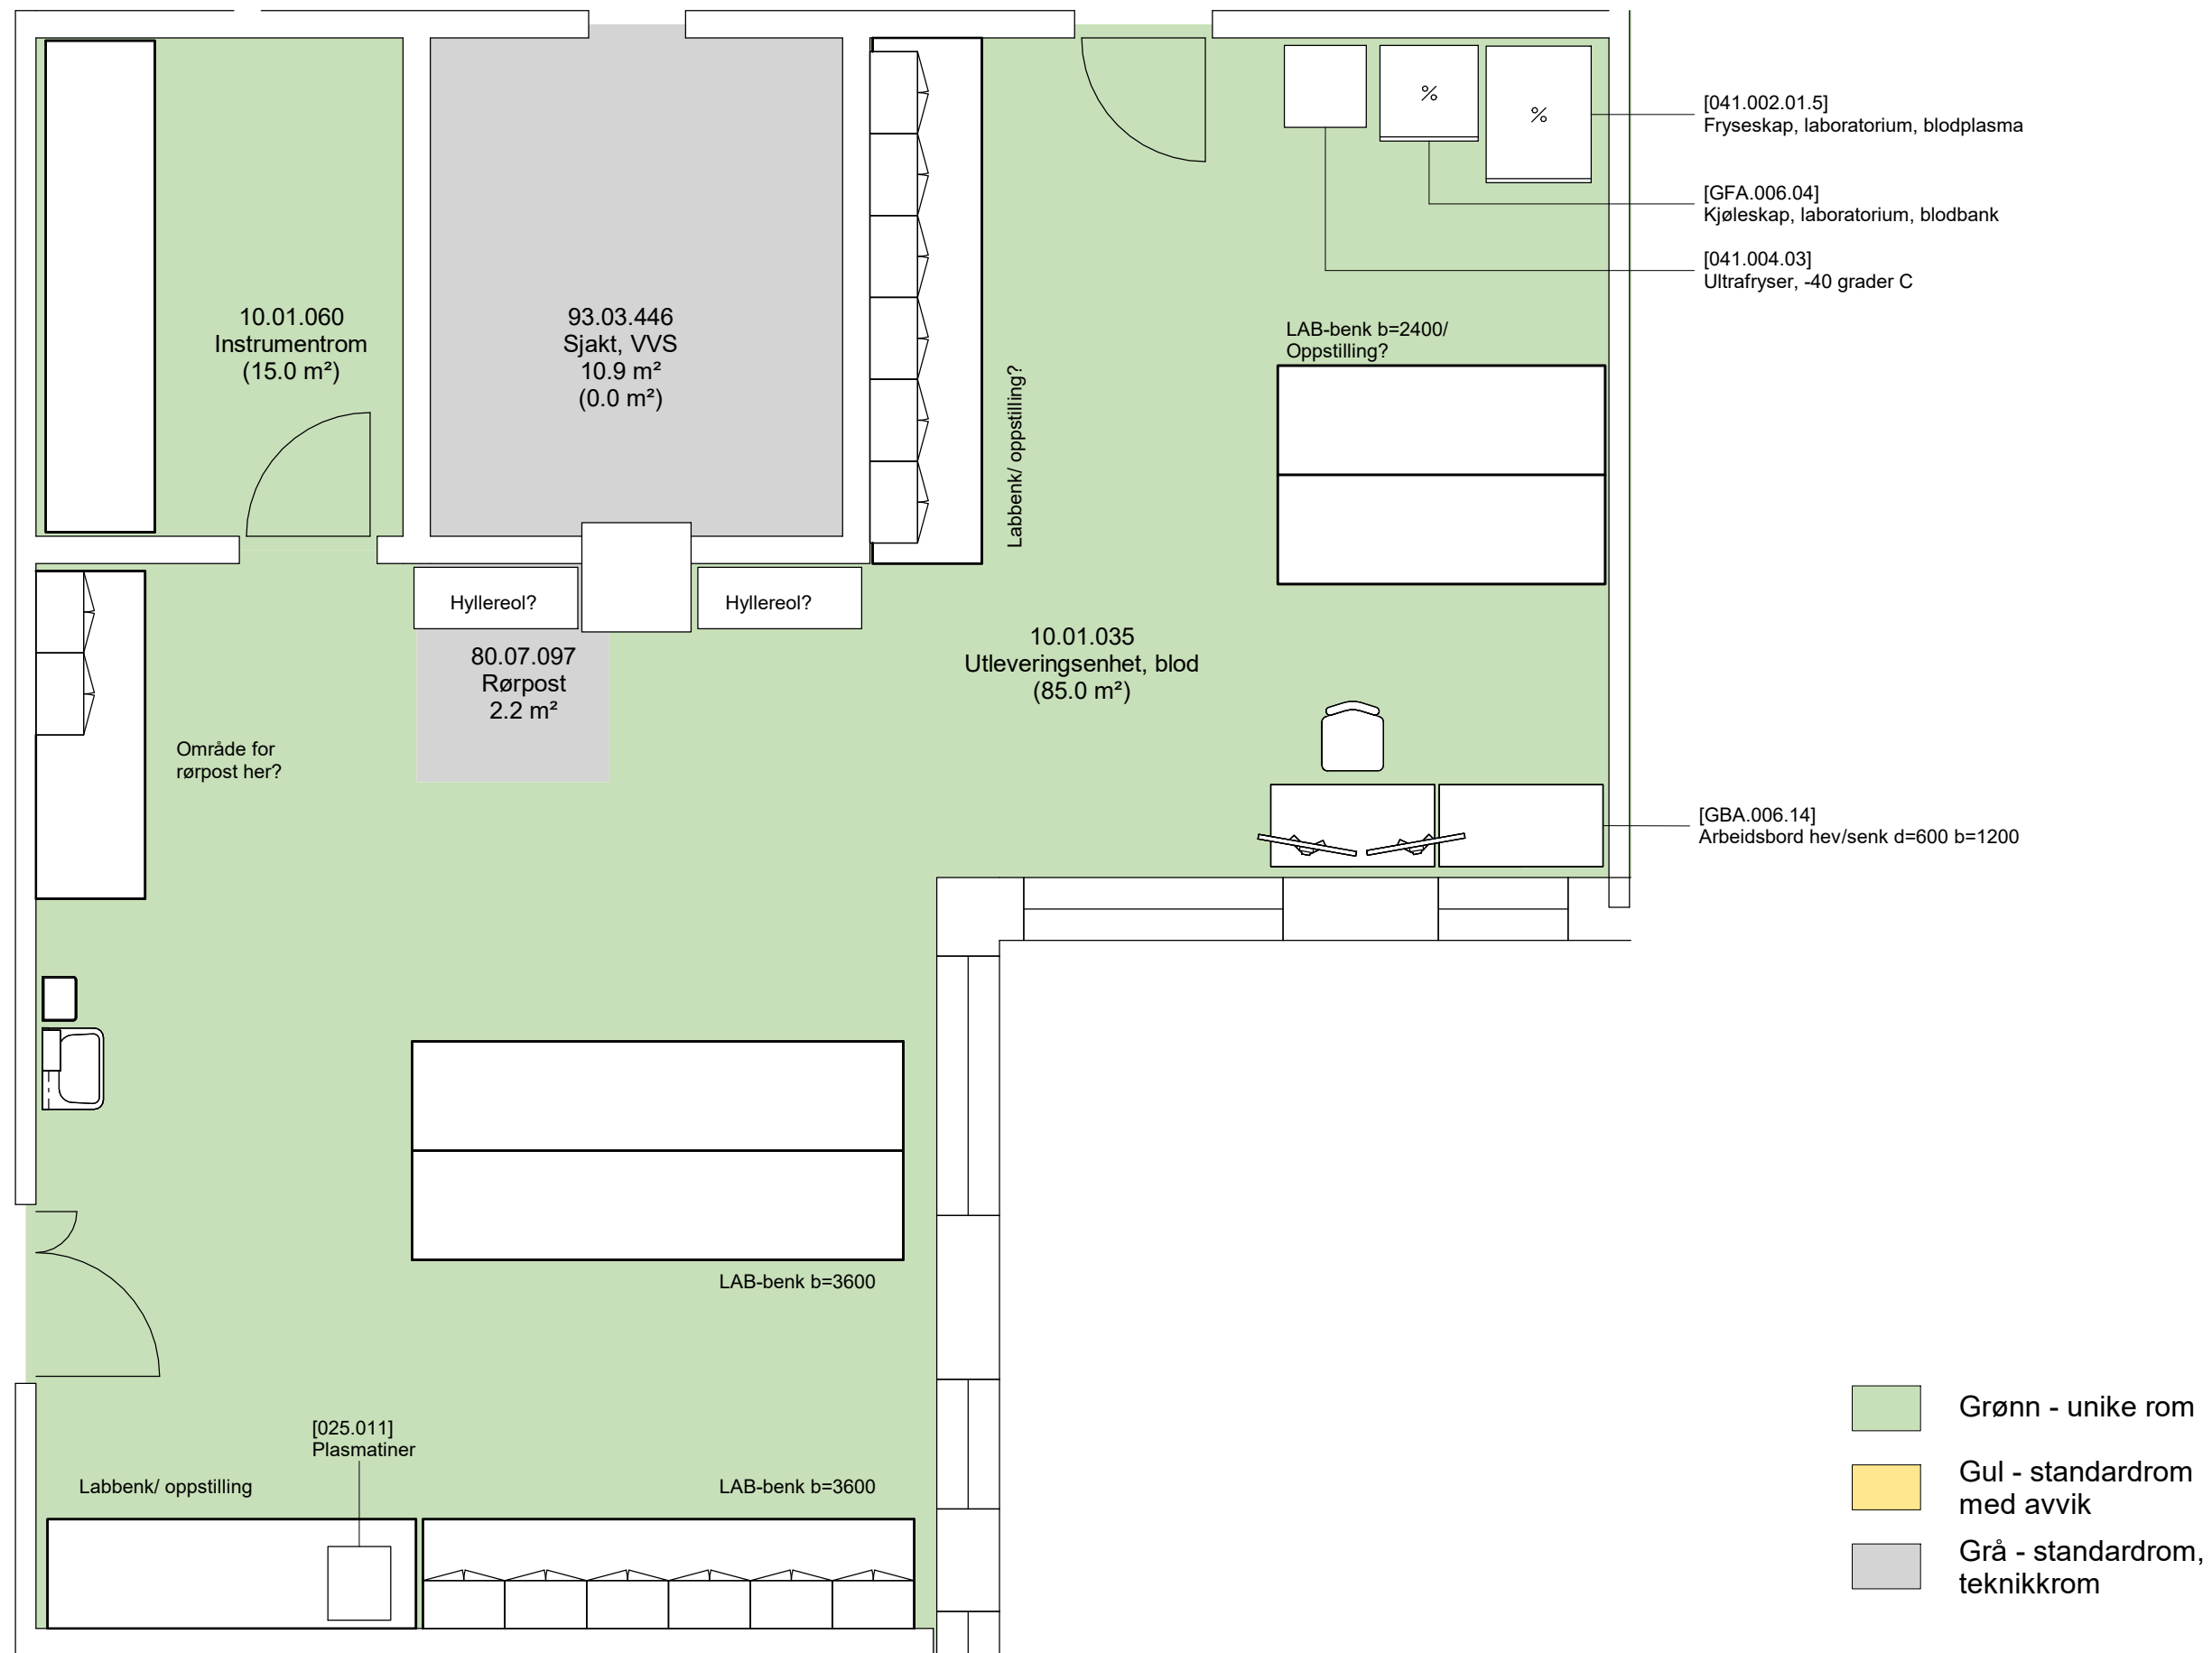

FORELØPIG TEGNING


Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 50

10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)



10.01.035 Utleveringsenhet blod

FORELØPIG TEGNING

Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker

Mål: 10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)

Avklaringspunkter til rom



10.01.035 UTLEVERING BLOD

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Plassering rørpost		Hvor bør den plasseres?		
2	Behov for avtrekkskap/punktavsug eller lignende?				
3	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?		Er foreslått løsning hensiktsmessig med tanke på arbeidsflyt?		

Avklaringspunkter til rom

10.01.059 LABORATORIUM, INSTRUMENTROM

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Hvilken type innredning og utstyr har man behov for å ivareta funksjonen i rommet?				
2	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker



Mål: 1 : 50

10.01.037 - Vaskerom

Avklaringspunkter til rom

10.01.037 VASKEROM

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Type og plassering av punktavsug?		Hva brukes punktavsug til?		
2	Brannskap	FSD.005	Hvilken funksjon har dette og hvor bør det plasseres?		
3	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?		Er foreslått løsning hensiktsmessig med tanke på arbeidsflyt?		
4	Er det korrekt angivelse av type II vann til laboratorievaskemaskin, ikke type III?		Type I vannrenseanlegg i utstyrsliste.		
5	Hvilken bredde er det behov for på avtrekkskap? Hva skal avtrekkskapet bestykes med mhp uttak?				
6	Type og størrelse kjemikalieskap	FAC.011 / Kjemikalieskap	Hvilke kjemikalier og mengder oppbevares i rommet?		

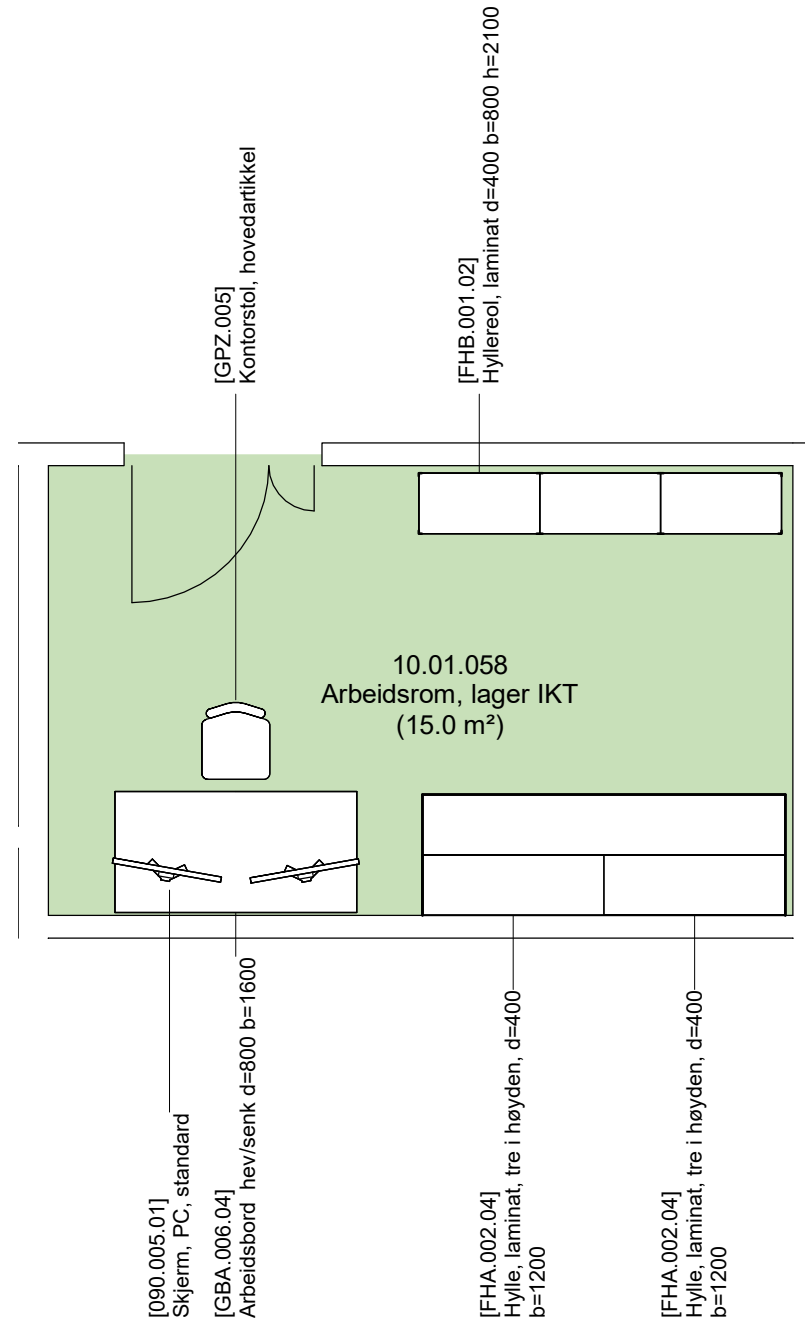

- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING

Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 50

10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT

Avklaringspunkter til rom

10.01.058 ARBEIDSRUM, IKT

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Hvilken type innredning og utstyr har man behov for å ivareta funksjonen i rommet?				
2	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				

Avklaringspunkter til rom

10.01.061 ARBEIDSROM, VAKTROM

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Hvilken type innredning og utstyr har man behov for å ivareta funksjonen i rommet?				
2	Hvor mange personer?				
3	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				

Avklaringspunkter til rom

10.01.003 LABORATORIUM, UTPRØVING

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Hvilken type innredning og utstyr er det behov for å ivareta funksjonen i rommet?				
2	Antall personer i rommet?				
3	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				

Avklaringspunkter til rom

10.01.040 LAGER

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Fordeling kjøl/frys mellom lagre?		Type og antall		
2	Behov for hyller/skap?		Type og antall		
3	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				

Avklaringspunkter til rom

10.01.038 LAGER

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Fordeling kjøl/frys mellom lagre?		Type og antall		
2	Behov for hyller/skap?		Type og antall		
3	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				

Avklaringspunkter til rom



10.01.039 LAGER

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Fordeling kjø/frys mellom lagre?		Type og antall		
2	Behov for hyller/skap?		Type og antall		
3	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				

Avklaringspunkter til rom

10.01.057 LAGER, KJEMIKALIER

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Hvilken type innredning og utstyr har man behov for å ivareta funksjonen i rommet?				
2	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				
3	Type og størrelse kjemikalieskap	FAC.011 / Kjemikalieskap	Hvilke kjemikalier og mengder oppbevares i rommet?		

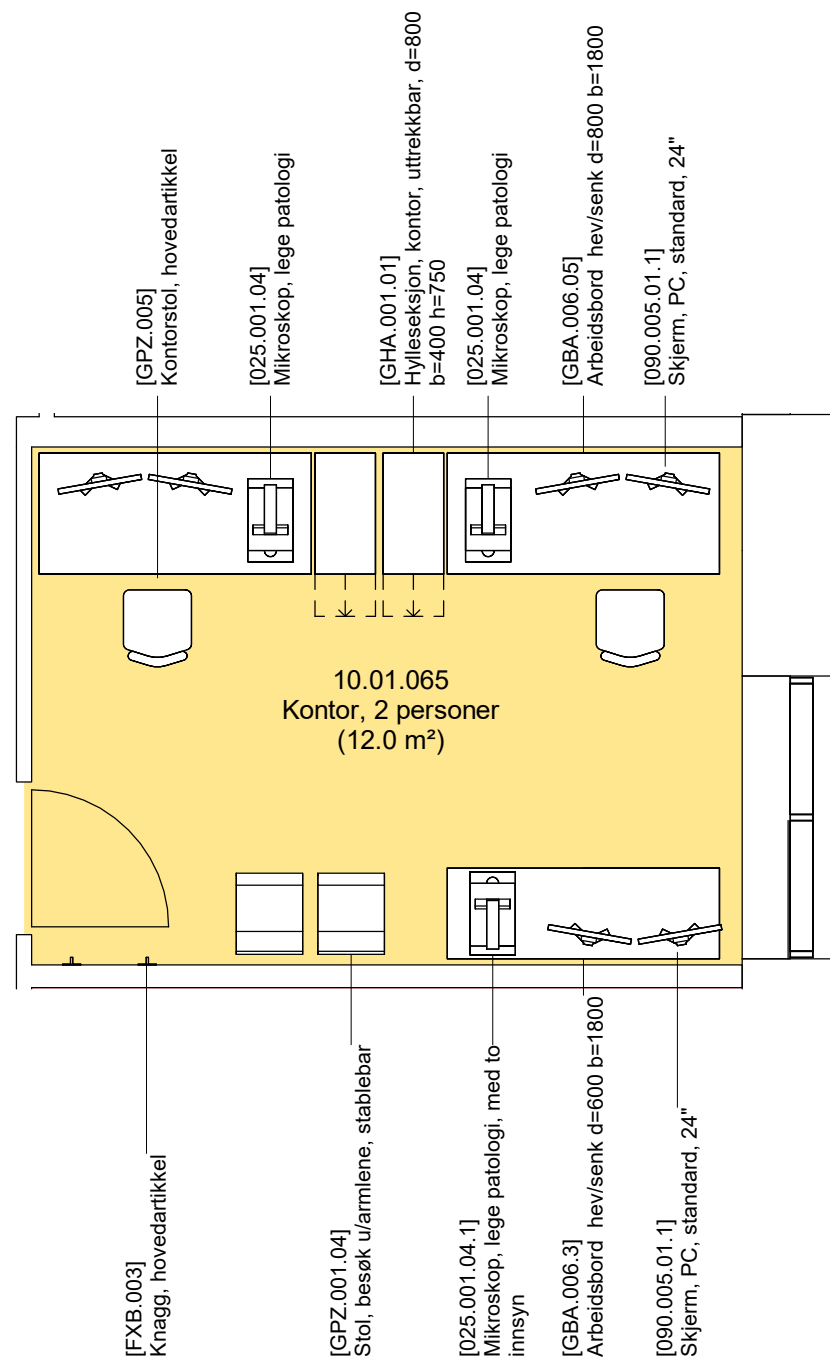

- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING

Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 50

10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)

Avklaringspunkter til rom

10.01.065 KONTOR, PATOLOG

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				



FORELØPIG TEGNING


Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 200

10.02. - Laboratoriemedisin - Prøvetaking, plan 01

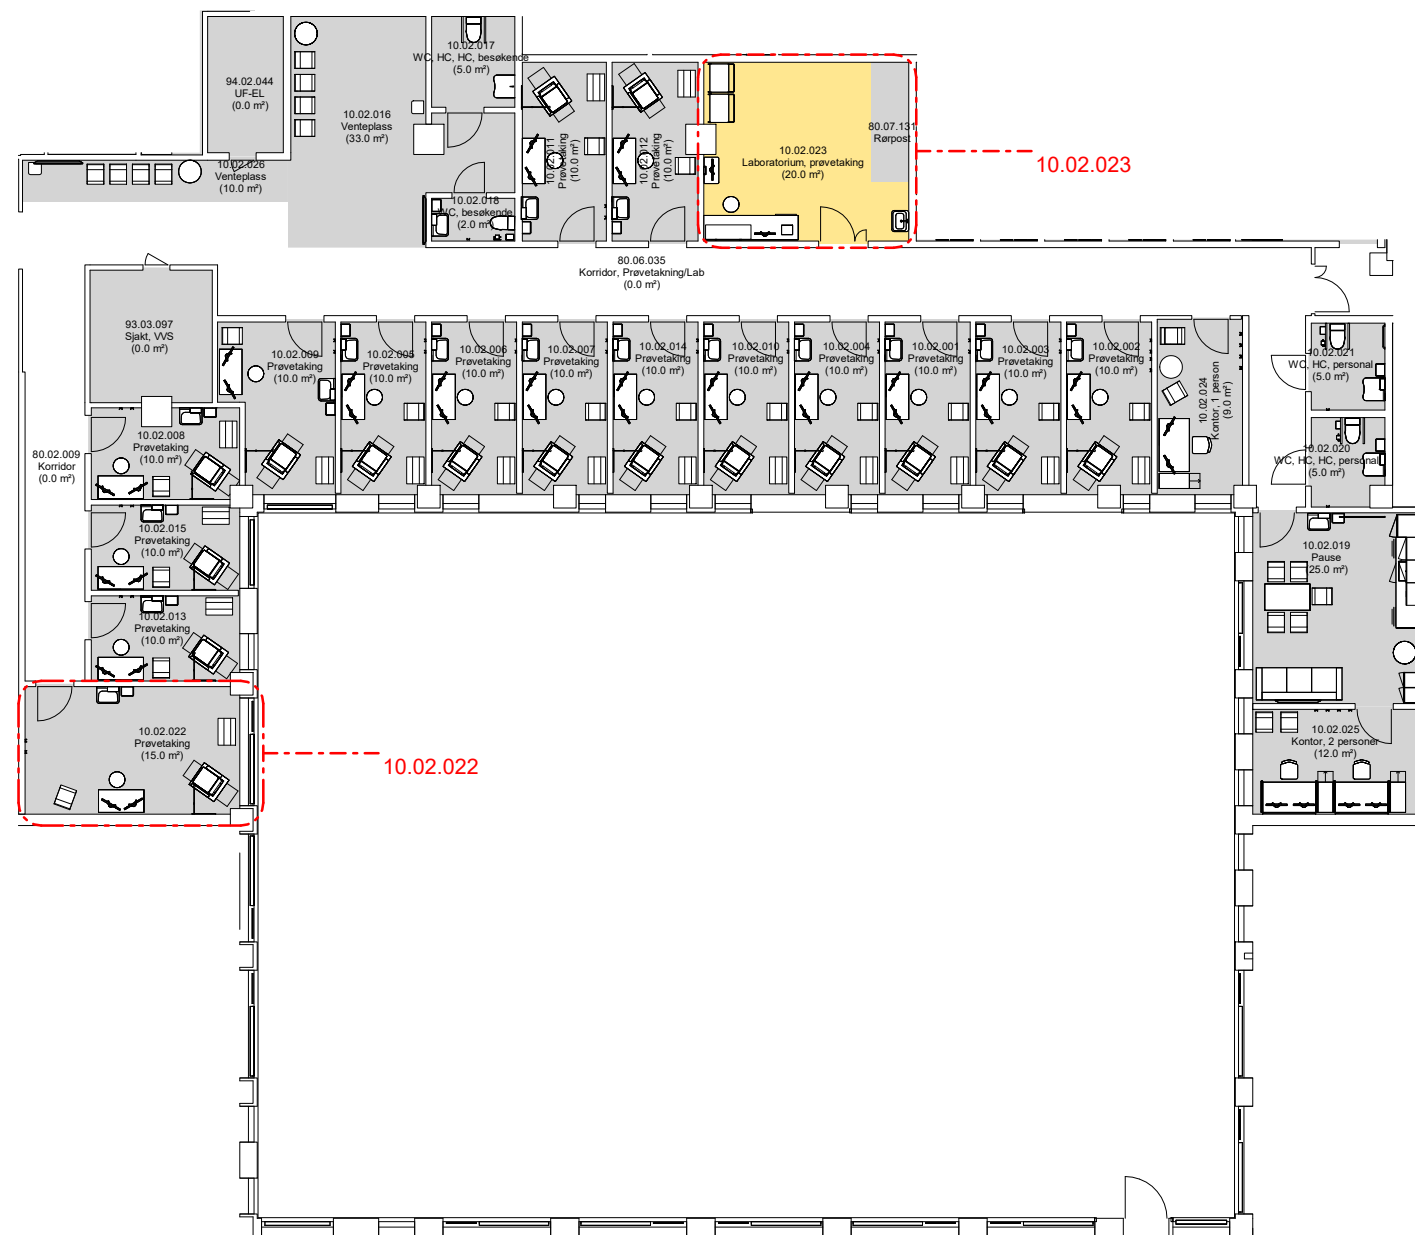

- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING



Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 200

10.02 - Laboratoriemedisin - Prøvetaking, plan 01



- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer



Dato: 09.05.2023
Mål: 1 : 50

Nye Aker
10.02.023 - Laboratorium, Prøvetaking

Avklaringspunkter til rom

10.02.022 PRØVETAKING

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				

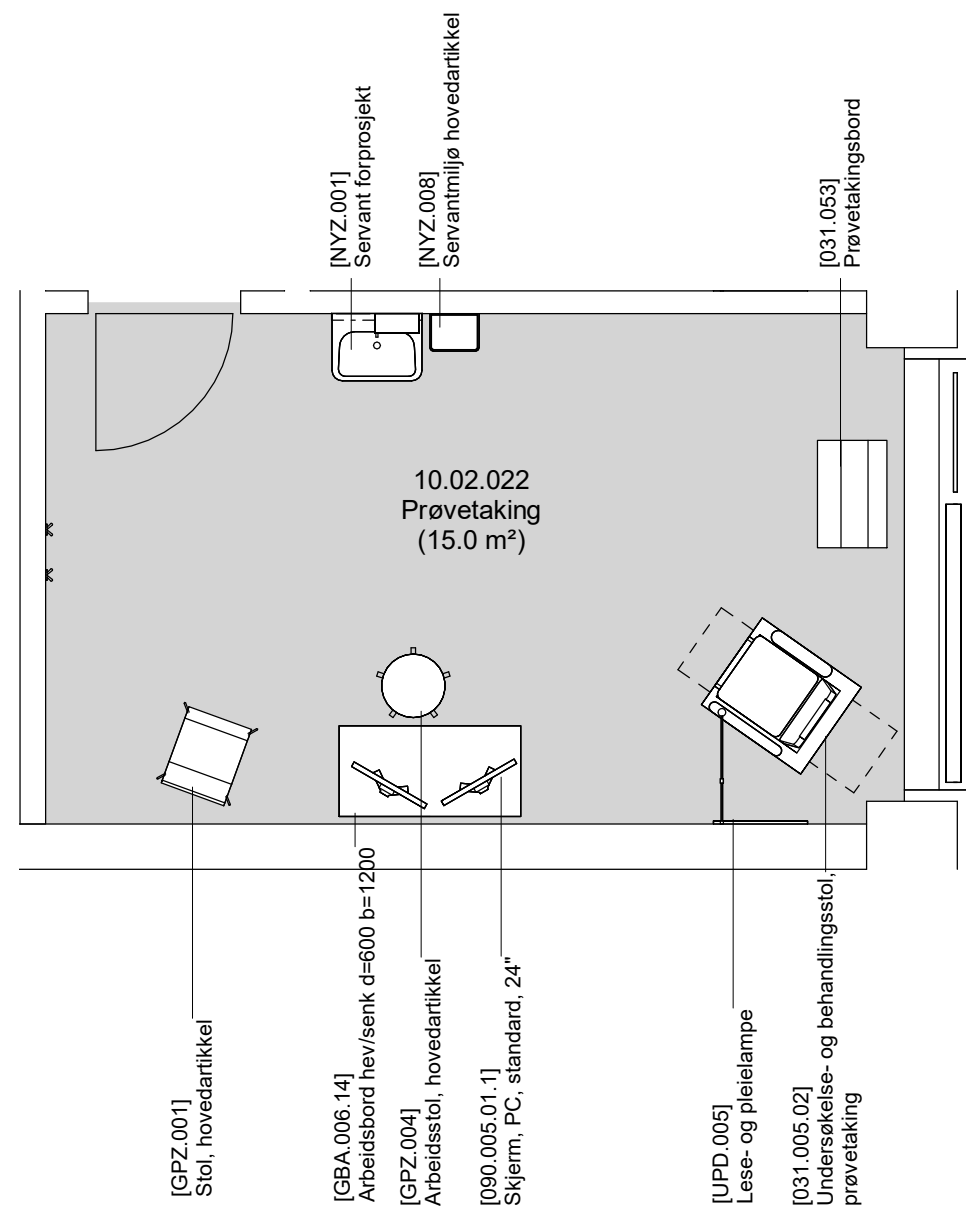

- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING

Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker



Mål: 1 : 50

10.02.022 - Prøvetaking

Avklaringspunkter til rom

10.02.023 LABORATORIUM, PRØVETAKING

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Spesifisert håndvask og utslagsvask i dRofus. Hva er behovet?				
2	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				
3	Kaldtvannstappekran på vegg i utstyrliste, men ikke i RFP. Hva skal denne benyttes til?				

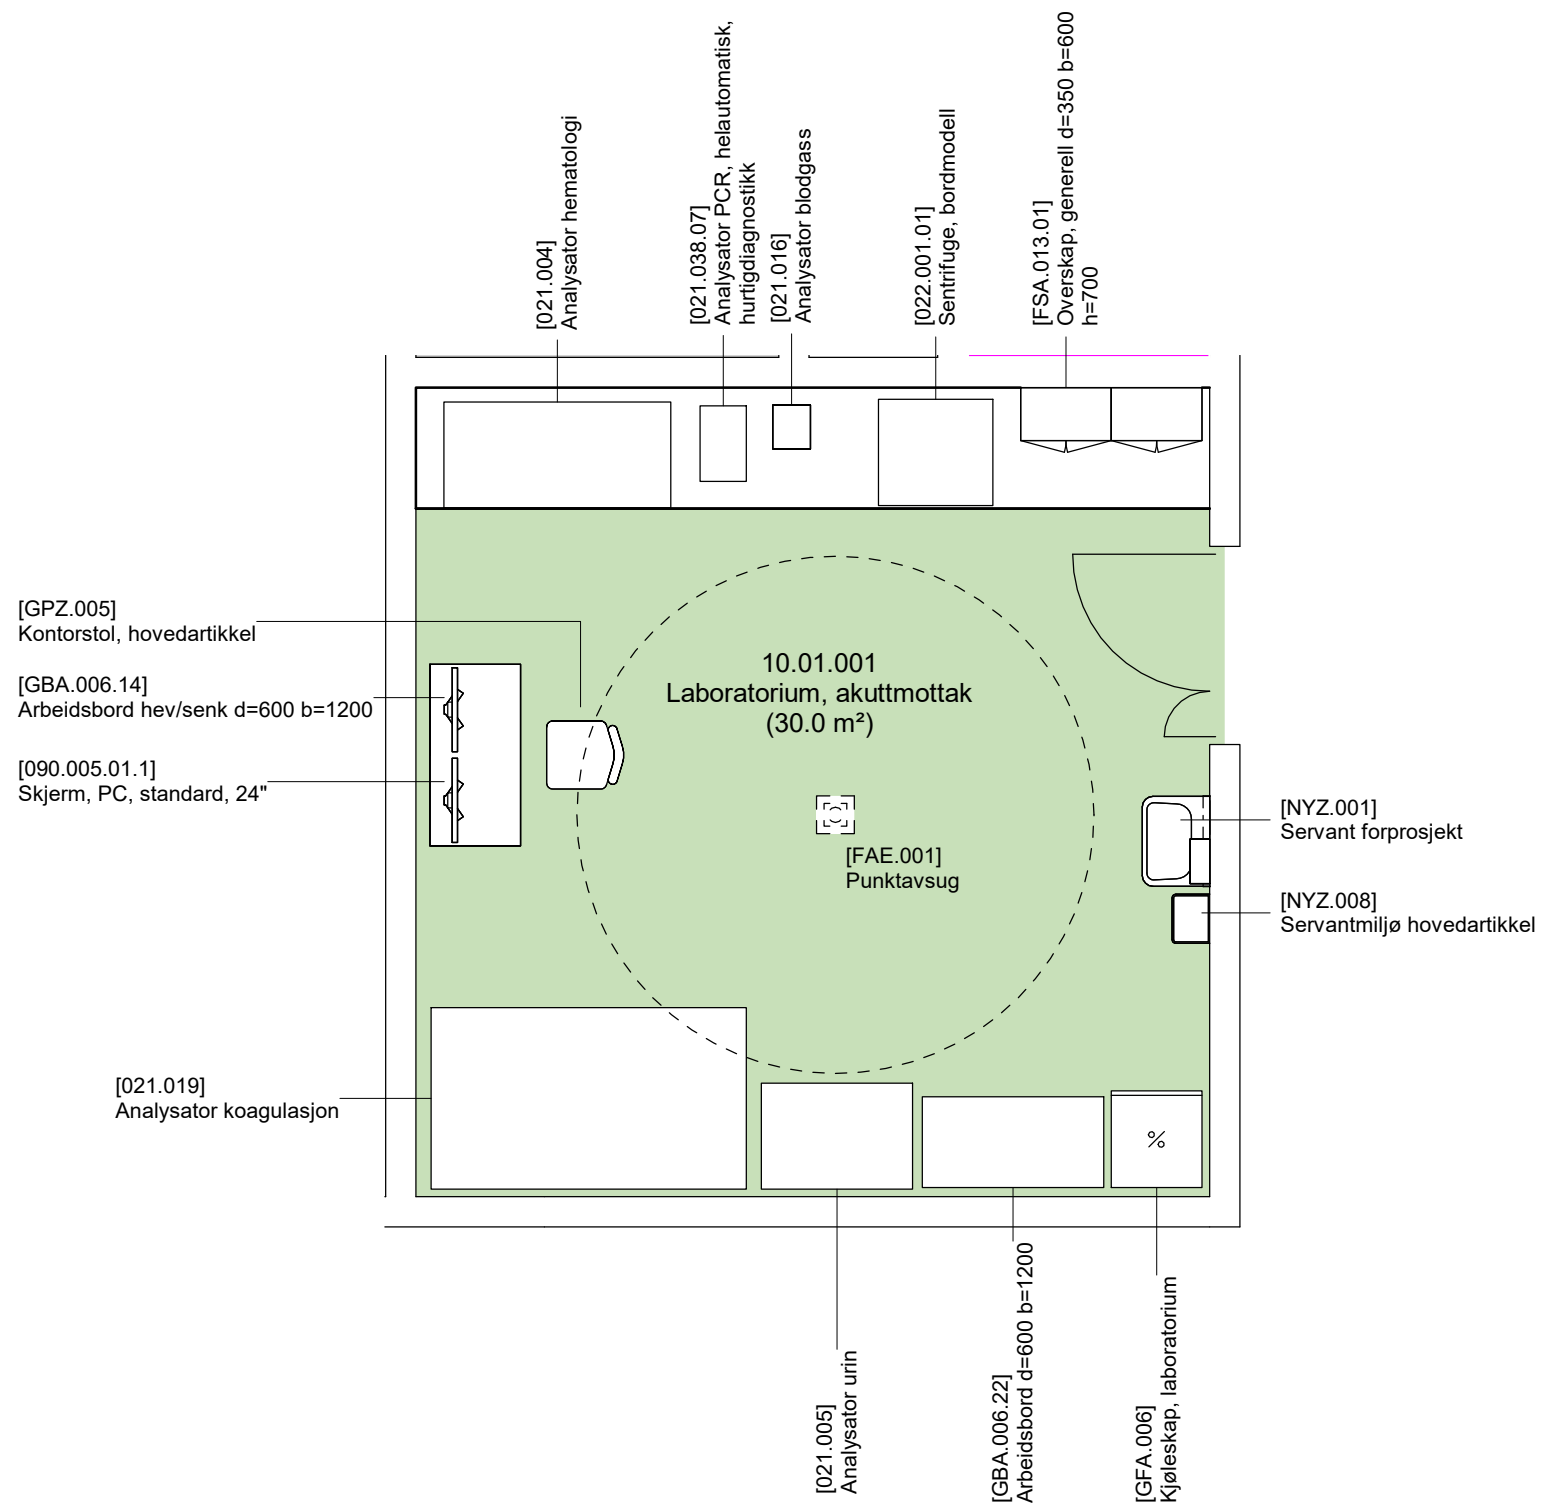

- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 09.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 50

10.01.001 - Laboratorium, akuttmottak

Avklaringspunkter til rom

10.01.001 Laboratorium, akuttmottak

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS		
1	Punktavsug	FAE.001	hvor bør dette plasseres? Over spesifikt utstyr eller arbeidsbenk?			
2	Sentrifuge		Skal det benyttes eget type bord / benk for sentrifuge?			
3	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?		Er foreslått løsning hensiktsmessig med tanke på arbeidsflyt?			

Avklaringspunkter til rom

10.03.019 Laboratorium, PNA (barsel)

	Avklaringen gjelder	Artikkelnummer / utstyr	Kommentar / annet	Svar fra OUS	
1	Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?				